

Máscaras de Uso Profissional

A DIFERENÇA ENTRE AS MÁSCARAS CIRÚRGICAS E N-95





1.) CIRÚRGICAS E N-95

São considerados produtos de saúde, sendo assim, devem atender a normas técnicas e sanitárias em relação aos seus processos de fabricação, distribuição, comercialização e principalmente, o seu uso.

2.) MÁSCARAS CIRÚRGICAS

Tem a finalidade de impedir ou dificultar a propagação de gotículas e o contágio por meio de microrganismos, do profissional para o paciente. São utilizadas para a proteção de gotículas a curta distância. Um ponto negativo, **ela não protege efetivamente contra aerossóis expelidos.**

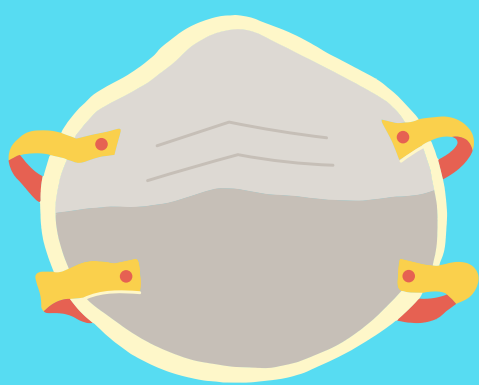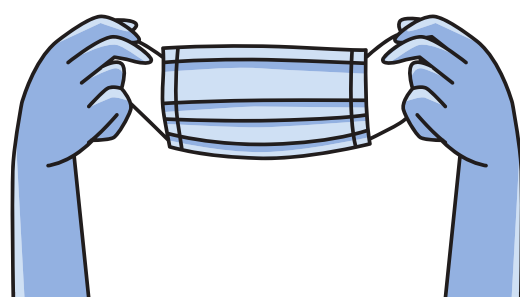


3.) N-95

Retém gotículas e protege o **TRABALHADOR** de aerossóis expelidos, contendo assim os vírus, bactérias e fungos. Podem ser utilizadas por maior período de tempo, desde que estejam íntegras, limpas e secas. Não é indicado o uso de máscaras vencidas.

4.) GOTÍCULAS X AEROSSÓIS

As **gotículas** são maiores (5 micrômetros) e podem contaminar as vias respiratórias altas, ou seja, as mucosas das cavidades nasais e orais. Os **aerossóis** são partículas menores do que as gotículas e ficam suspensas no ar por períodos longos de tempo, podem se infiltrar mais profundamente no trato respiratório.

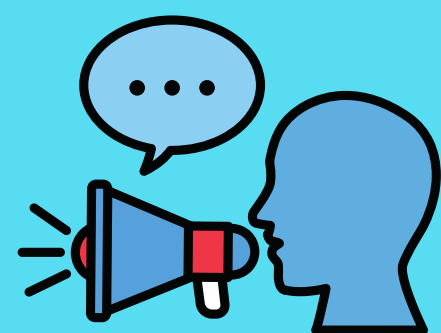

5.) ATENÇÃO!

É necessário o **uso racional** dos EPIs nos serviços de saúde, se trata de um **recurso finito** e importante para uma assistência segura dos profissionais que se encontram na linha de frente da Pandemia.